


患者様名: 森田 花子

測定日: 2017年 11月 8日

むし歯のチェックをした結果です。

日頃のご家庭での口腔ケアにお役立てください。

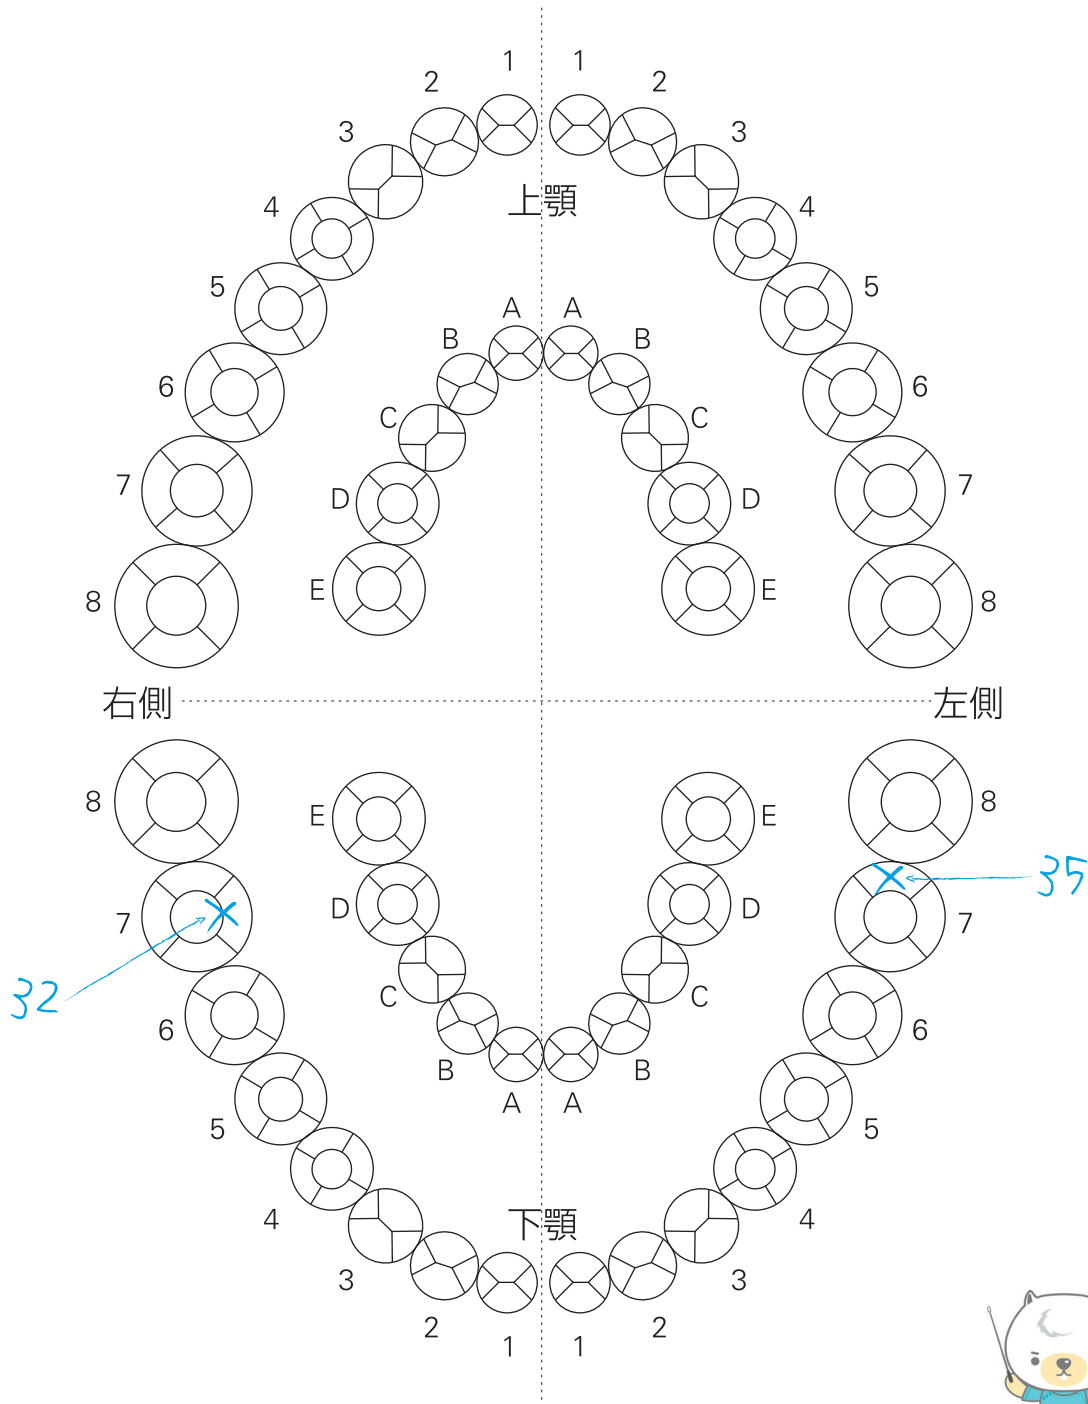

測定値と目安

測定値	目安
0~15	健全な歯です
16~40	初期むし歯の可能性ががあります。進行しないように定期検診による経過観察と処置が必要です。
41~99	治療が必要です

所見

初期むし歯の可能性ががあります。
進行しないように定期検診による経過観察と処置が必要です。